

检验检测报告

(电子版)

扫码下载报告



No: 200056882

防伪查询网址: www.gttc.net.cn

防伪码: RRTP-6510-44

共3页 第1页



委托单位	肇庆博涵体育用品有限公司 地址: 肇庆高新区康泰街2号之一		
样品信息	防护口罩 40个 商标: 口口福 批号款号: 20200315 颜色: 白色 号型规格: KKF-1A 生产单位: 肇庆博涵体育用品有限公司		
检验性质	委托检测	样品受理/测试开始日期	2020-04-03
		报告签发日期	2020-04-13
判定依据	GB 2626-2006 《呼吸防护用品 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》		
综合检验结论	---		
检验检测结果	检验检测项目	判定依据	判定
	NaCl颗粒物过滤效率	GB 2626-2006	符合
	吸气阻力	GB 2626-2006	符合
	呼气阻力	GB 2626-2006	符合
	可燃性	GB 2626-2006	符合
	头带	GB 2626-2006	符合
备注	本报告中检验检测项目均在相应标准规定的环境条件下进行(有注明的除外)。复印件、副本未重新加盖报告书确认章无效。本报告检验检测地址为广州市番禺区珠江路1号。		

签发: 郭子山 高级工程师

郭子山




样品图片

(电子版)

No:200056882

共3页 第2页

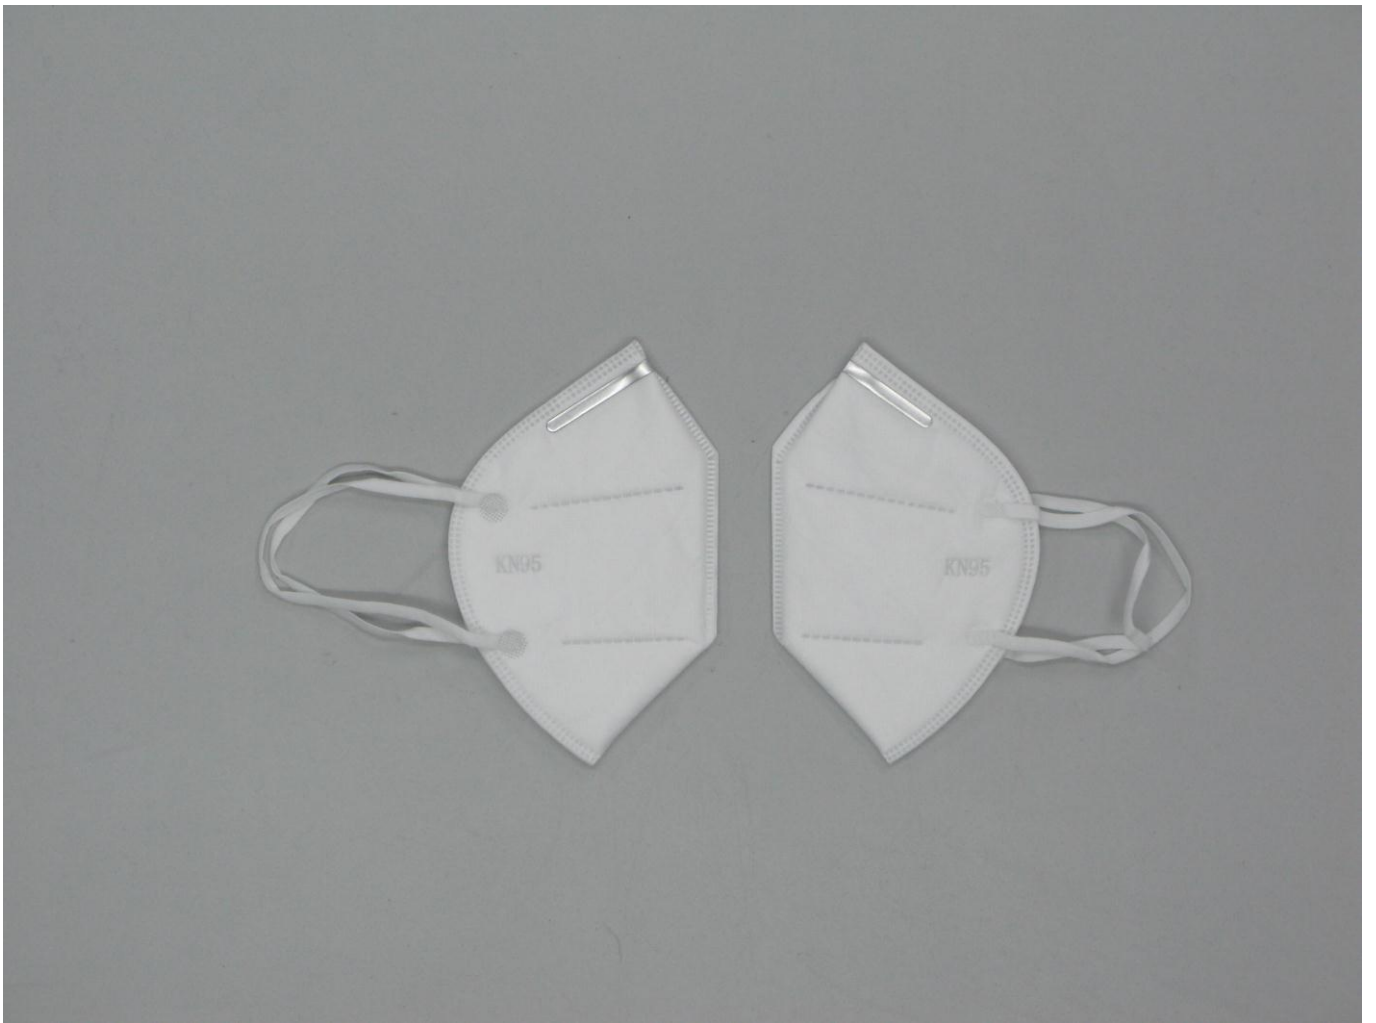

检验检测报告附页 (电子版)

No: 200056882

共3页 第3页

检验检测项目 (计量单位) [样品识别]	测试方法	标准值及允差	检验检测结果	判定	备注
●NaCl颗粒物过滤效率	GB 2626-2006 6.3 空气流量:85L/min 气溶胶颗粒:NaCl 气溶胶浓度:15mg/m ³ 温度:24.3℃ 相对湿度:38.1%	过滤效率(%): ≥95.0 (KN95)	过滤效率(%): 未处理样品 1# 99.896 2# 99.980 3# 99.982 4# 99.915 5# 99.978 6# 99.960 7# 99.954 8# 99.953 9# 99.947 10# 99.952 温湿度预处理后样品 1# 99.910 2# 99.813 3# 99.947 4# 99.890 5# 99.913	符合	
●吸气阻力(Pa)	GB 2626-2006 6.5 头模: 中号	≤350	未处理样品: 1# 103.7 2# 100.2 预处理样品: 1# 106.0 2# 104.3	符合	
●呼气阻力(Pa)	GB 2626-2006 6.6 头模: 中号	≤250	未处理样品: 1# 59.7 2# 61.5 预处理样品: 1# 61.1 2# 58.0	符合	
●可燃性(s)	GB 2626-2006 6.15	续燃时间 ≤5	续燃时间 未处理样品 1# 0.0 2# 0.0 温湿度预处理后样品 3# 0.0 4# 0.0	符合	
●头带	GB 2626-2006 6.11	面罩的每条头带、带扣及其他调节部件在承受10N的拉力, 持续10s, 不应出现滑脱或断裂。	未处理样品: 1# 符合要求 温湿度预处理后样品: 1# 符合要求	符合	
备 注	(本栏空白)				



——本报告结束——